

CERTIFICAT

MELAG Medizin Technik

*Pour votre sécurité, ce cabinet est équipé d'un
Stérilisateur à la vapeur d'eau*

Fabriqué dans nos usines de Berlin - RFA

Vacuklav[®] Premium Plus

Autoclave de classe B

Conformes aux Normes Européennes

NF EN 285 & NF EN 13060-2

Stérilisation de tous dispositifs médicaux

&

NF EN 554 & NF EN 17665-1

Validation & Qualification opérationnelle




MELAG[®] France
competence in hygiene

MELAG France - 37 rue Michel Carré - 95100 ARGENTEUIL





Dans un souci de total respect de la chaîne d'hygiène et de maîtrise des infections croisées, ce cabinet dentaire est équipé pour votre sécurité d'un X-Cidol®2 de MICRO-MEGA® qui réalise automatiquement la pré-désinfection et le nettoyage des instruments dynamiques systématiquement avant toute intervention.

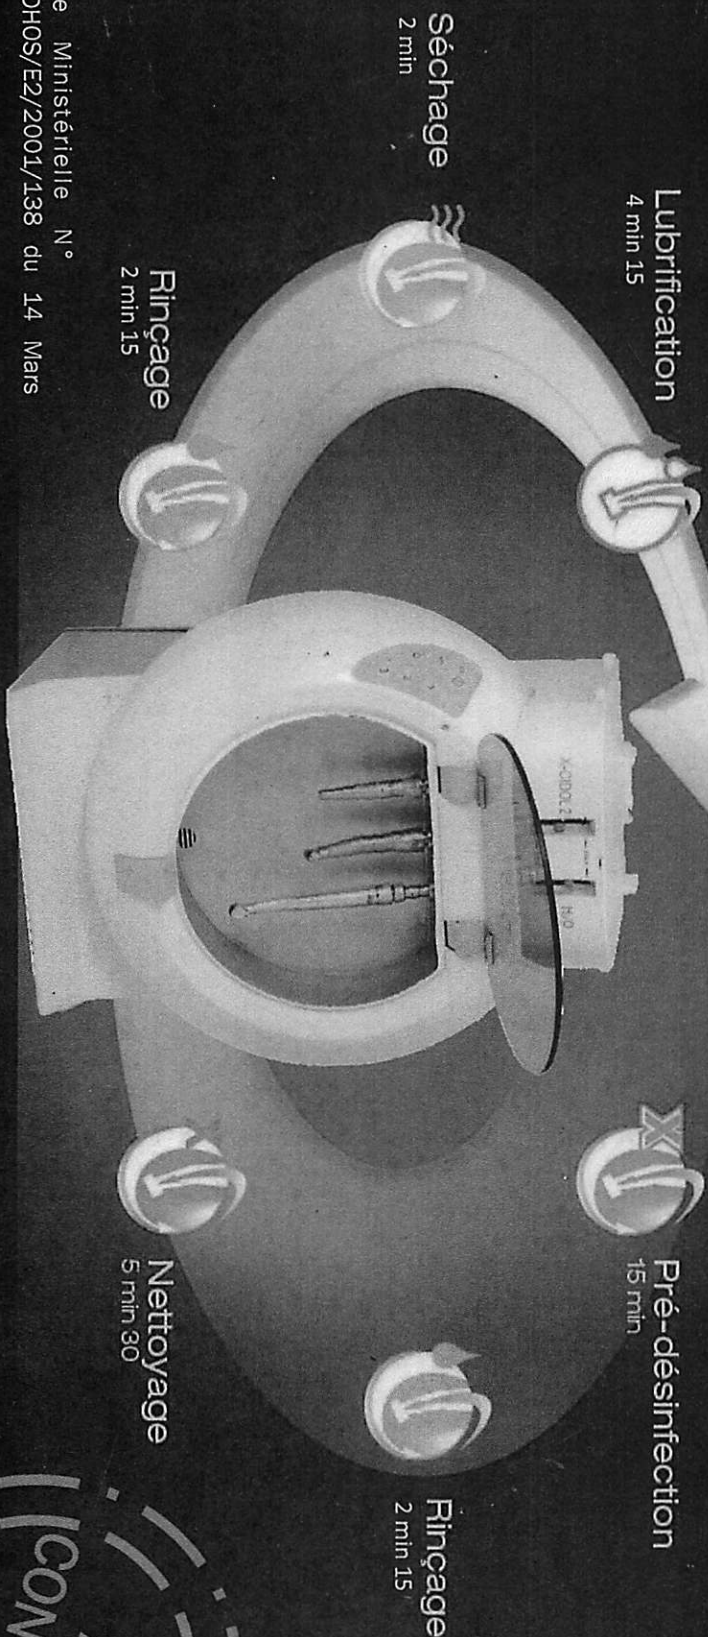

- Suivant :
- Circulaire Ministérielle N° DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 Mars 2001.
 - Guide de prévention des infections liées aux soins réalisés en chirurgie dentaire et en stomatologie - Ministère de la Santé, DGS, Juillet 2006
 - Guide de bonnes pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé-Mars 2006

X-Cidol®2

- Le X-Cidol®2 est un produit détergent désinfectant présentant une activité:
 - Détergente
 - Bactéricide : testée selon les normes NF EN 1040, NF EN 13727 et NF EN 14561.
 - Fongicide : testée selon les normes NF EN 1275, NF EN 13624 et NF EN 14562.
 - Tuberculocide : testée selon la norme NF EN 14563.
 - Virucide : HIV 1, virus PRV (virus modèle Hépatite B), BVDV (virus modèle Hépatite C) et Herpès Simplex.

